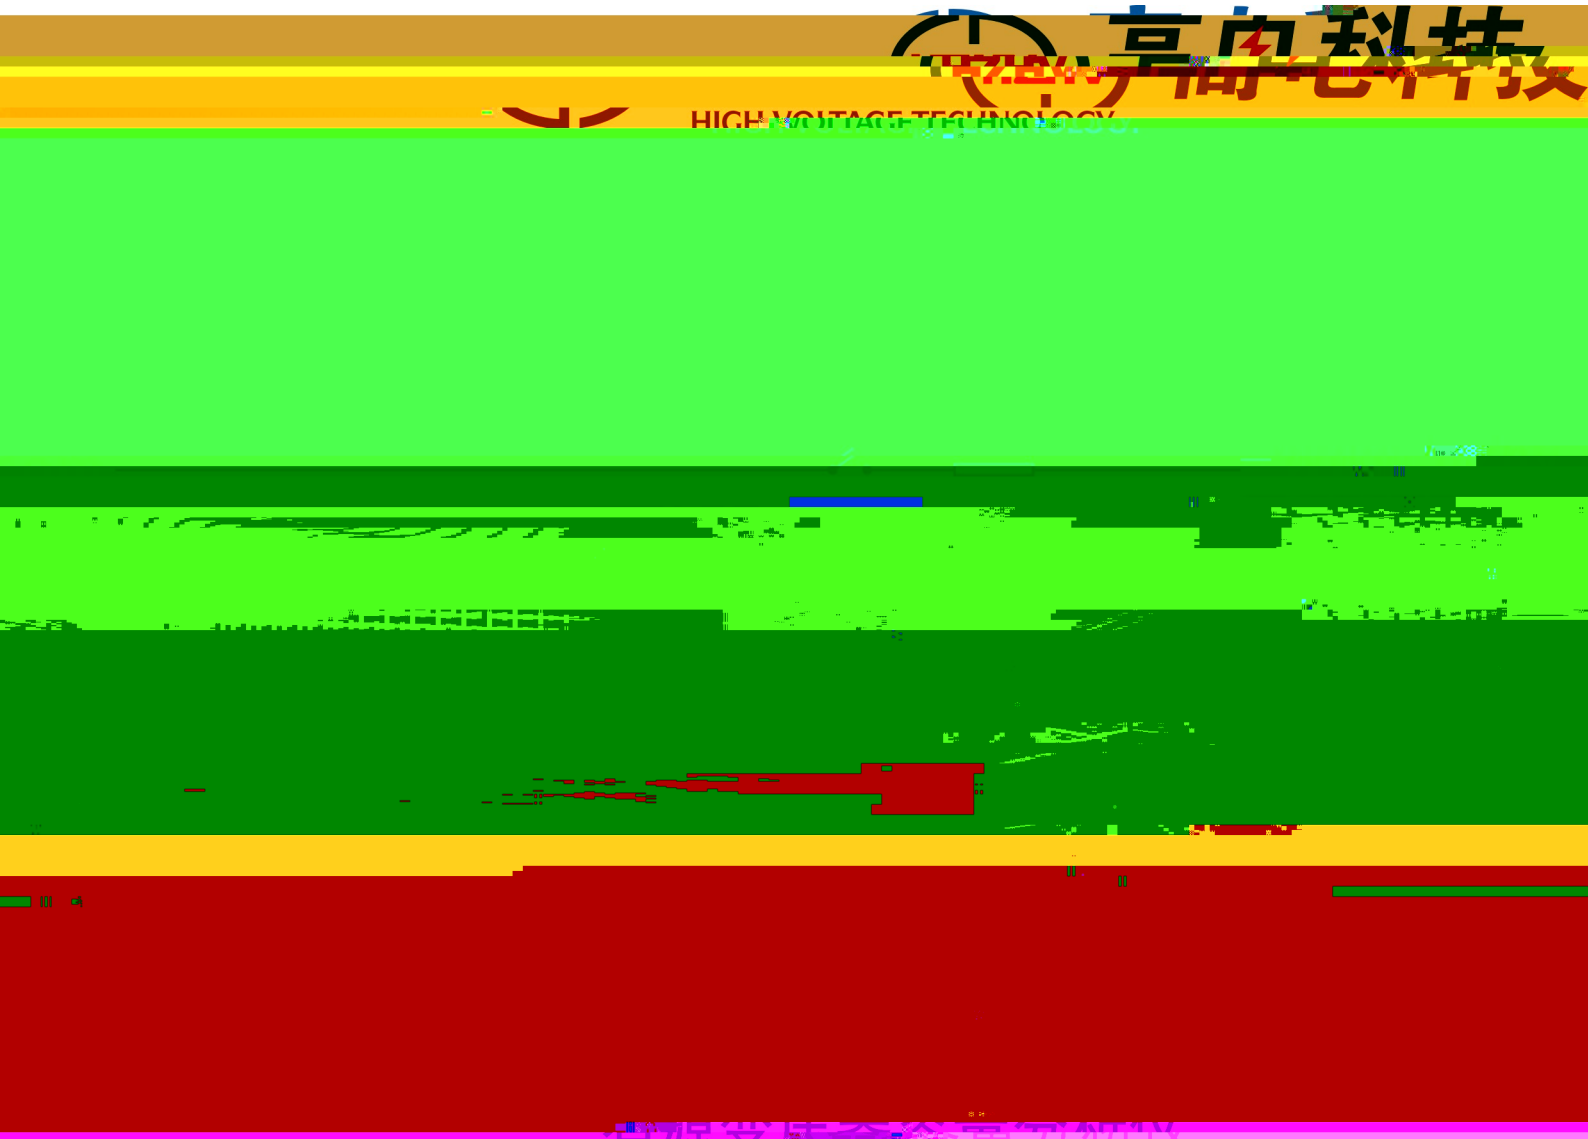


# 电源变压器绝缘强度分析仪

# 使用说明书

杭州高电科技有限公司

A 220V

USB USB

1. ( )
2.
3.
4. 220V (10A
5. 2 2

6.
7.
8.
9. USB USB
10. USB U U
11.
12.
13.
14.

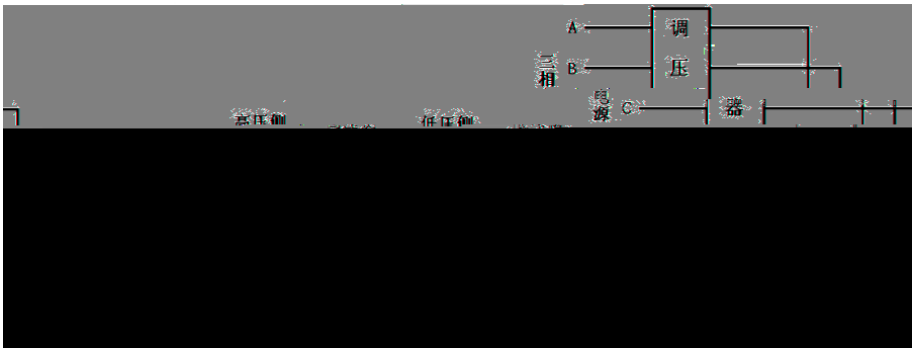
A
B
C
调
压
器

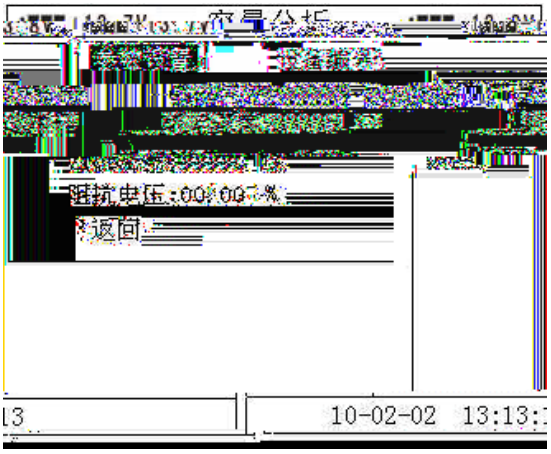
返回
10-02-02 13:13:

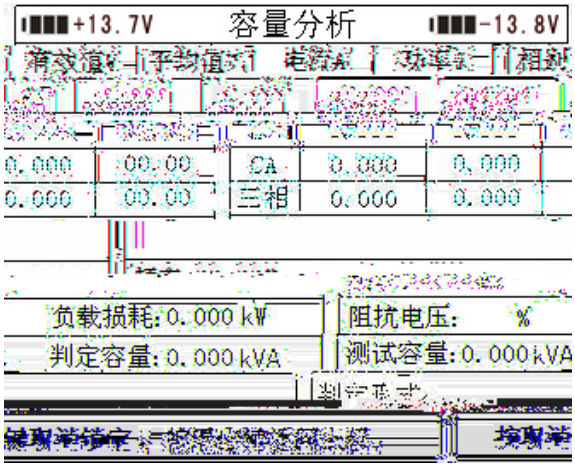
+13.7V
容量分析
-13.8V
有效值
平均值
电流A
功率
相
0.000
00.00
CA
0.000
0.000
0.000
00.00
三相
0.000
0.000
负载损耗:0.000 kW
阻抗电压:
%
判定容量:0.000 kVA
测试容量:0.000kVA

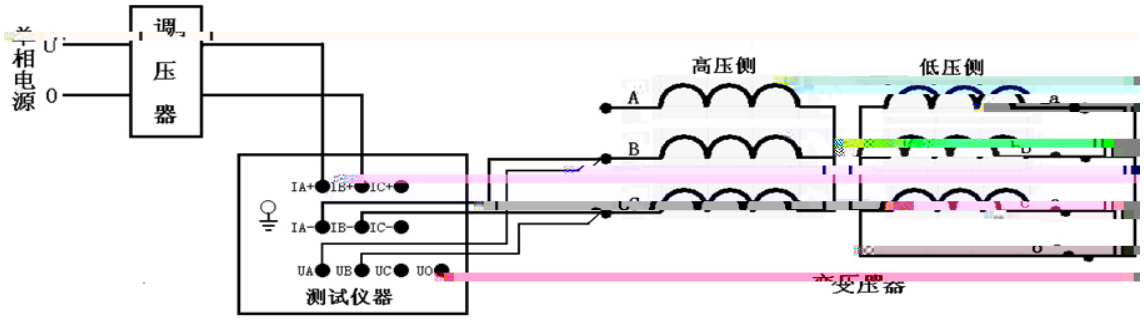
单相电源
U
0
调压器
高压侧
低压侧
A
B
C
a
b
c
IA+
IB+
IC+
IA-
IB-
IC-
UA
UB
UC
UO
测试仪器
变压器

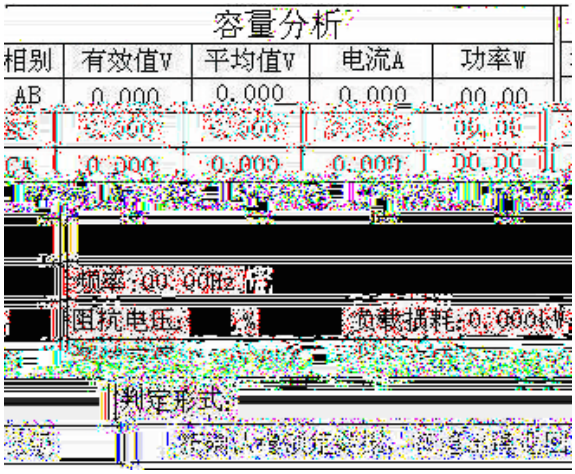
容量分析
相别
有效值V
平均值V
电流A
功率W
AB
0.000
0.000
0.000
00.00
0.000
0.000
00.00
频率:00.00Hz
负载损耗:0.0001W
判定形式:

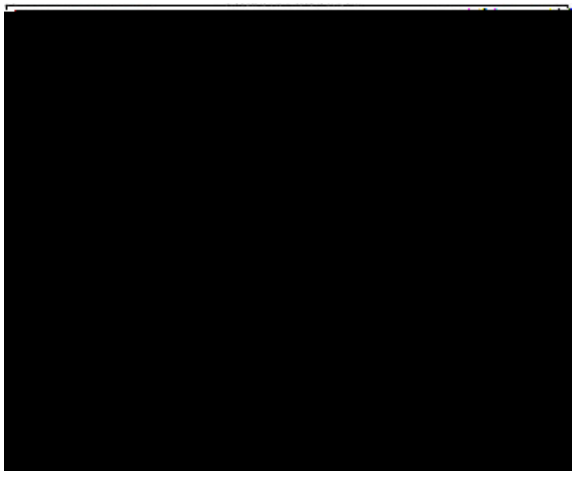

80

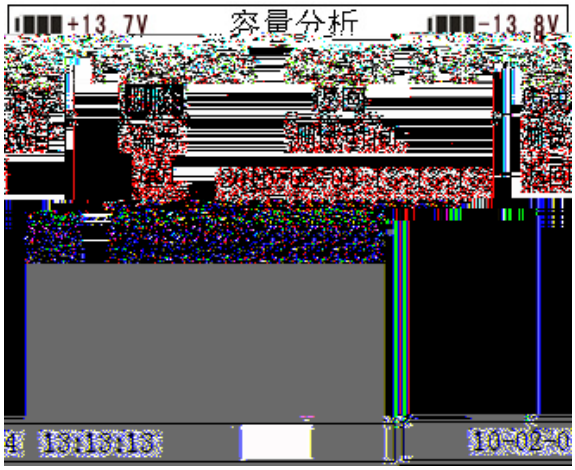


80

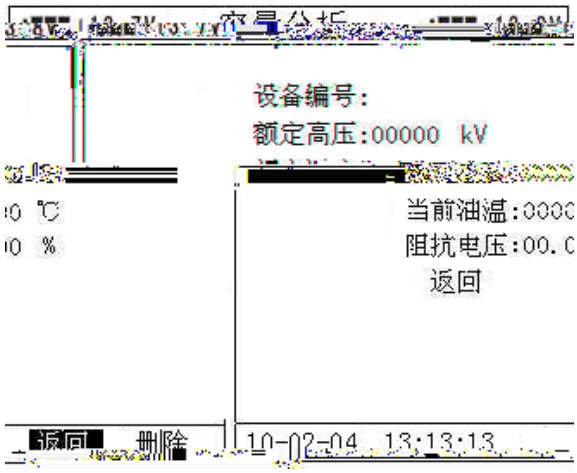


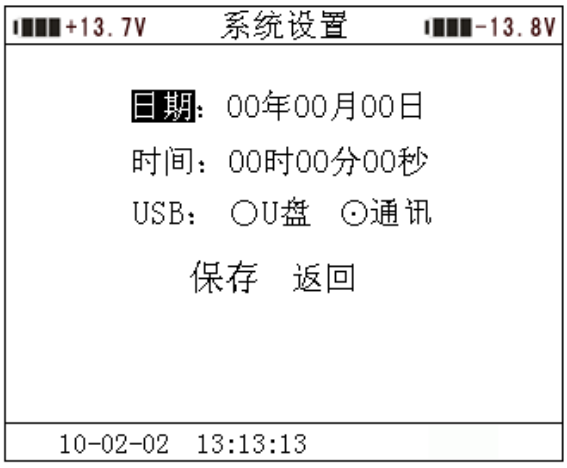


( USB ),

( )

USB U USB U

USB

USB U ( USB )

U

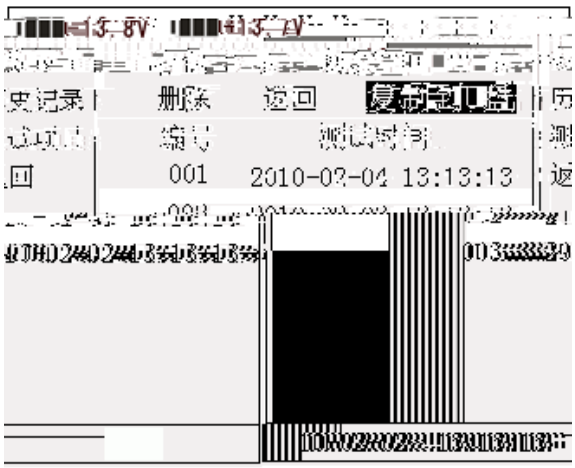


U U

U

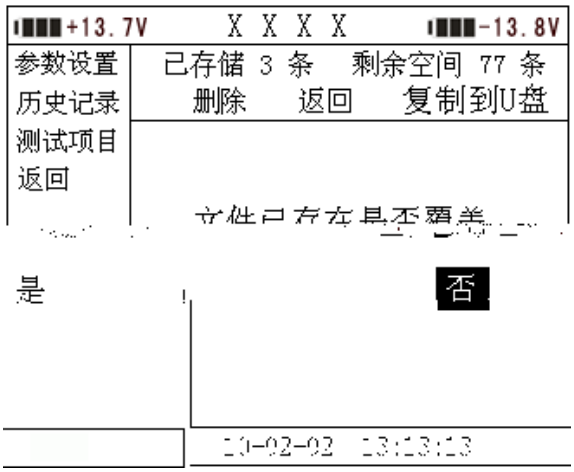

1

2 ,

3

4

5

6

7

8

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

S

Uk

SN UN--

IN Ik--

S Uk--

Uk%-- (%)

= /1.5

50kVA 4%

Ik/IN =1 (50 4)/100=2kW

50% Ik/IN=0.5 2KW 0.5 0.5=0.5kW

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4.5 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5.5

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |